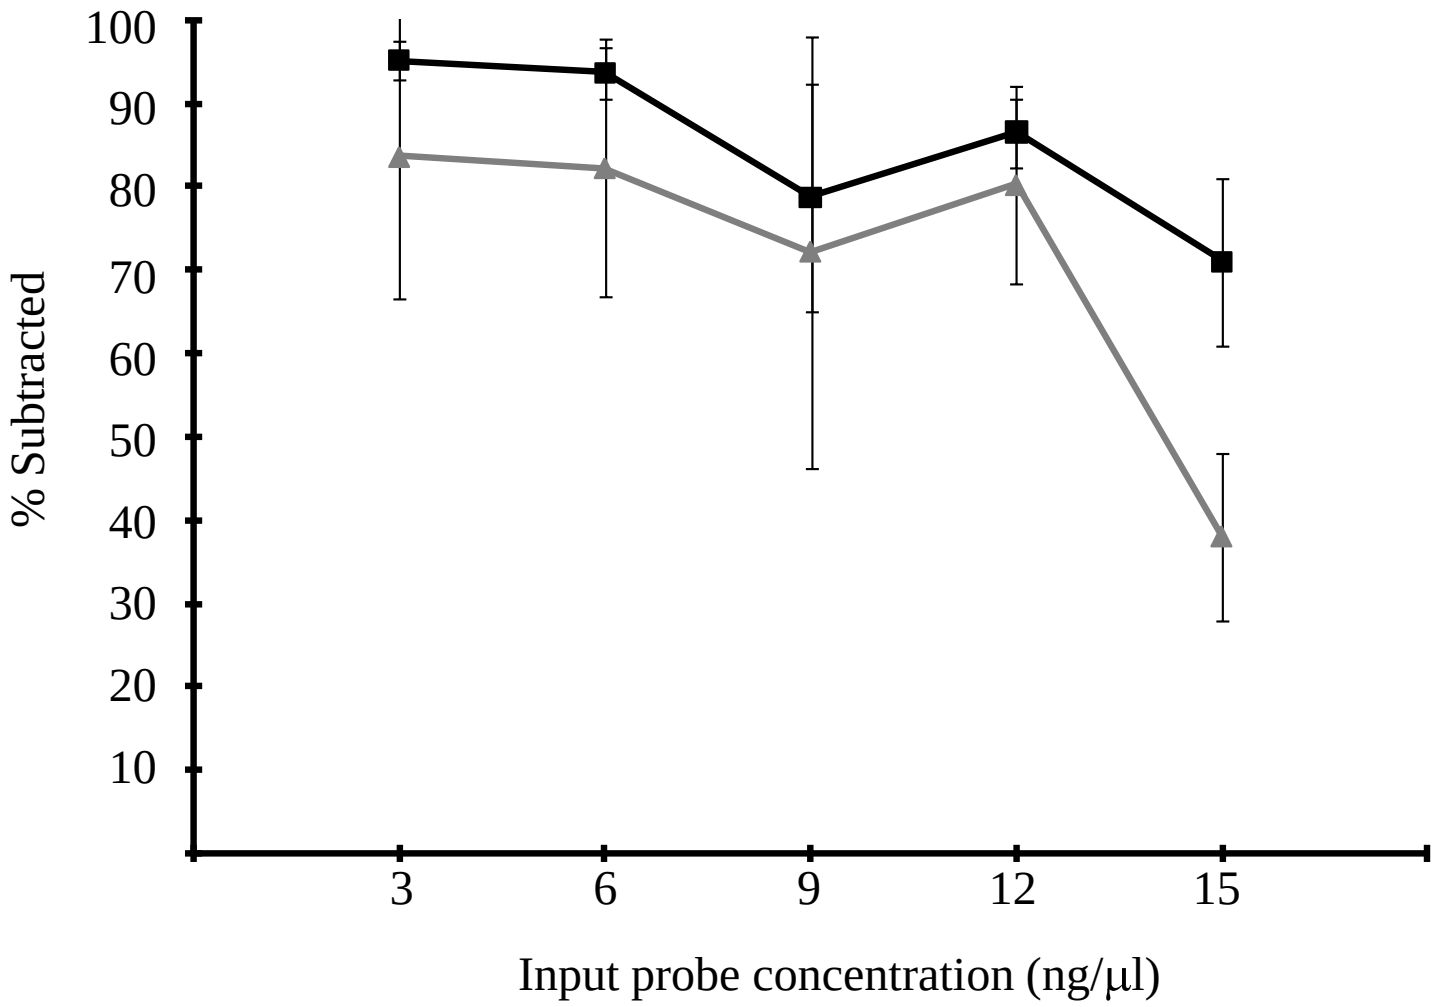
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
% Subtracted
3
6
9
12
15
Input probe concentration (ng/μl)